



Mako Yoshida  
04 Jul / 2025




| 送信器名称<br>CH番号 | 治験冷蔵庫I①<br>CHI                      | 治験冷蔵庫I②<br>CHI                      | 治験冷蔵庫C①<br>CHI                      | 治験冷蔵庫C②<br>CHI                      | 治験冷蔵庫H①<br>CHI                      | 治験保冷庫J①<br>CHI                      |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位            | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   |
| 収録データ数        | 4320                                | 4320                                | 4320                                | 1440                                | 4320                                | 4320                                |
| 欠損データ数        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 測定間隔          | 00:10:00                            | 00:10:00                            | 00:10:00                            | 00:30:00                            | 00:10:00                            | 00:10:00                            |
| 最高値           | 4.7                                 | -29.6                               | 4.7                                 | -19.7                               | 5.2                                 | 6.0                                 |
| 最低値           | 4.2                                 | -30.2                               | 4.4                                 | -20.1                               | 4.7                                 | 4.5                                 |
| 平均値           | 4.5                                 | -29.9                               | 4.5                                 | -19.9                               | 4.9                                 | 5.4                                 |
| 開始日時          | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 |
| 終了日時          | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:30:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 |

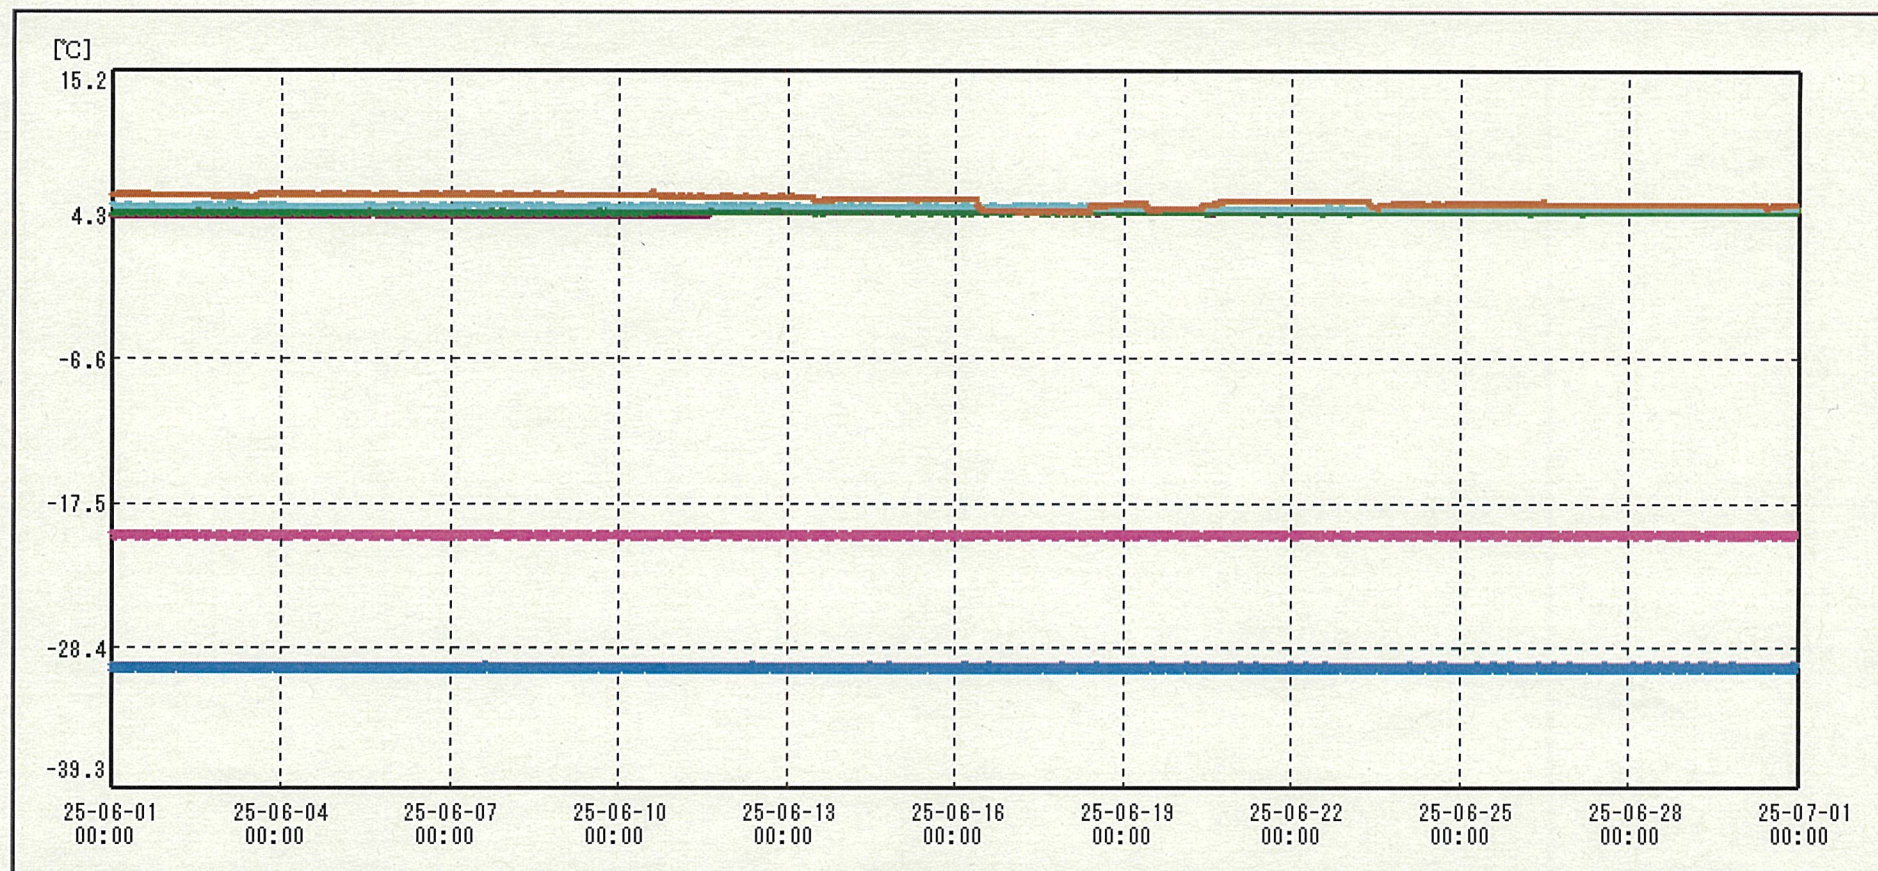

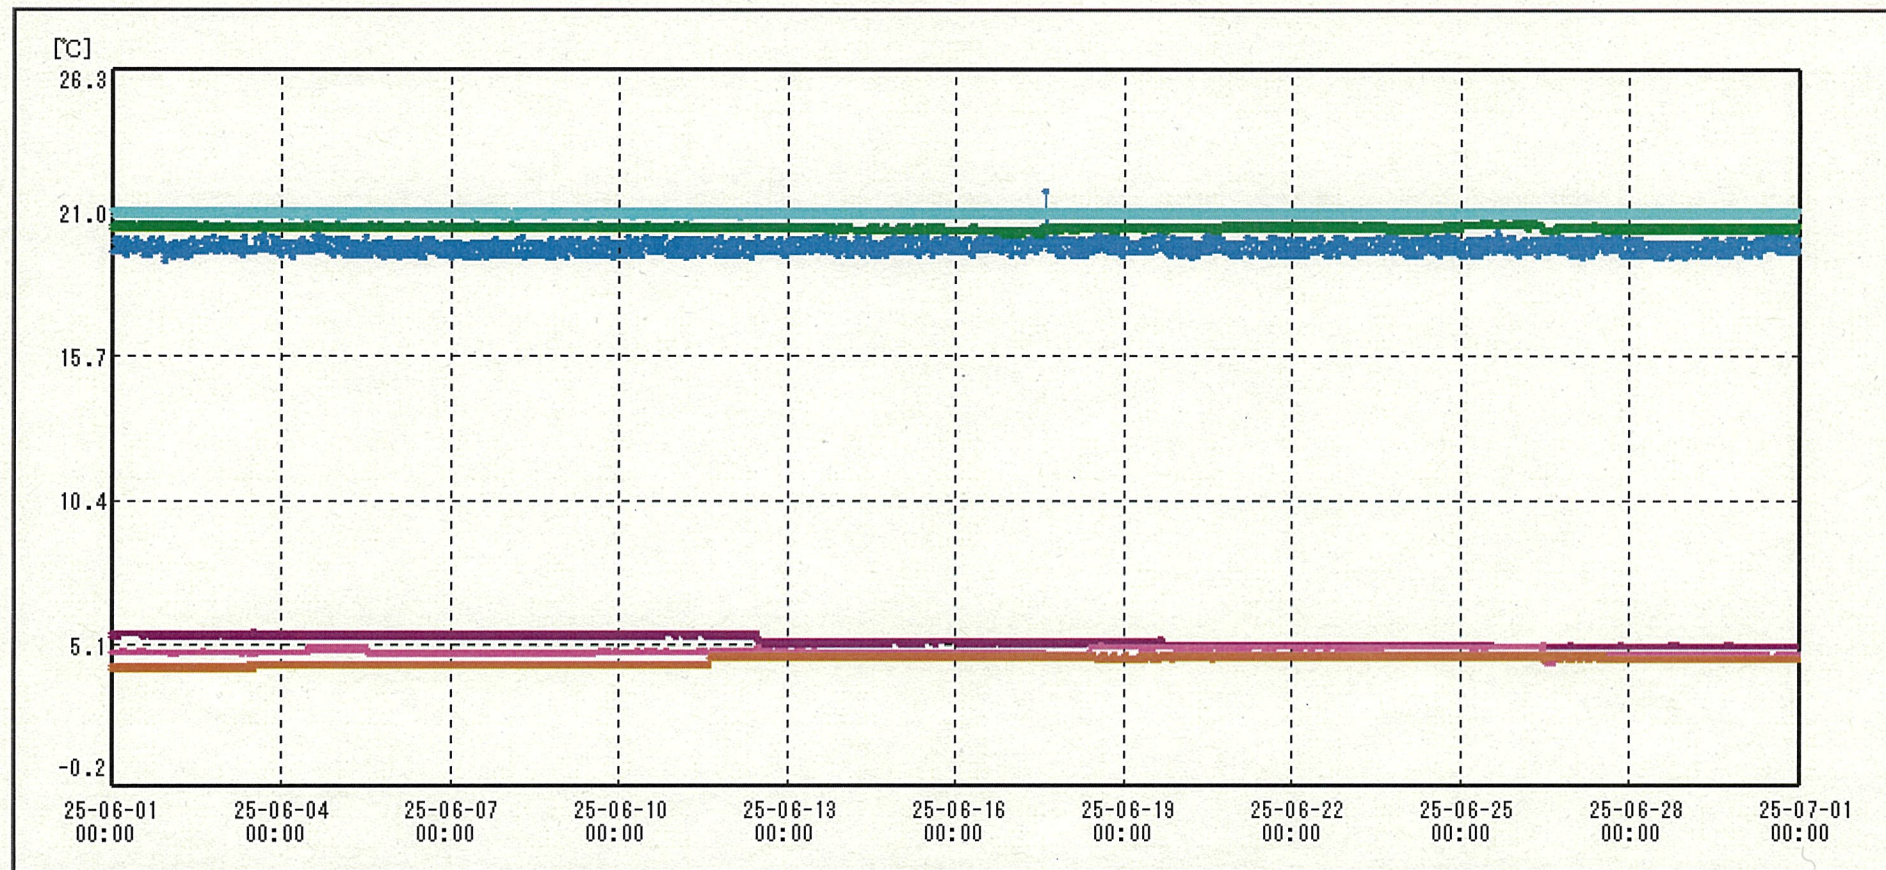


| 送信器名称<br>CH番号 | 治験冷蔵庫K①<br>CHI                      | 治験保管室室温①<br>CHI                     | 治験恒温槽B①<br>CHI                      | 治験冷蔵庫P①<br>CHI                      | 治験恒温槽Q①<br>CHI                      | 治験冷蔵庫I①<br>CHI                      |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位            | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   |
| 収録データ数        | 4320                                | 4320                                | 4320                                | 4320                                | 4320                                | 4320                                |
| 欠損データ数        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 測定間隔          | 00:10:00                            | 00:10:00                            | 00:10:00                            | 00:10:00                            | 00:10:00                            | 00:10:00                            |
| 最高値           | 5.6                                 | 21.8                                | 20.7                                | 5.1                                 | 21.1                                | 4.7                                 |
| 最低値           | 5.0                                 | 19.2                                | 20.2                                | 4.4                                 | 20.8                                | 4.2                                 |
| 平均値           | 5.2                                 | 19.7                                | 20.4                                | 4.8                                 | 21.0                                | 4.5                                 |
| 開始日時          | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 |
| 終了日時          | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 |



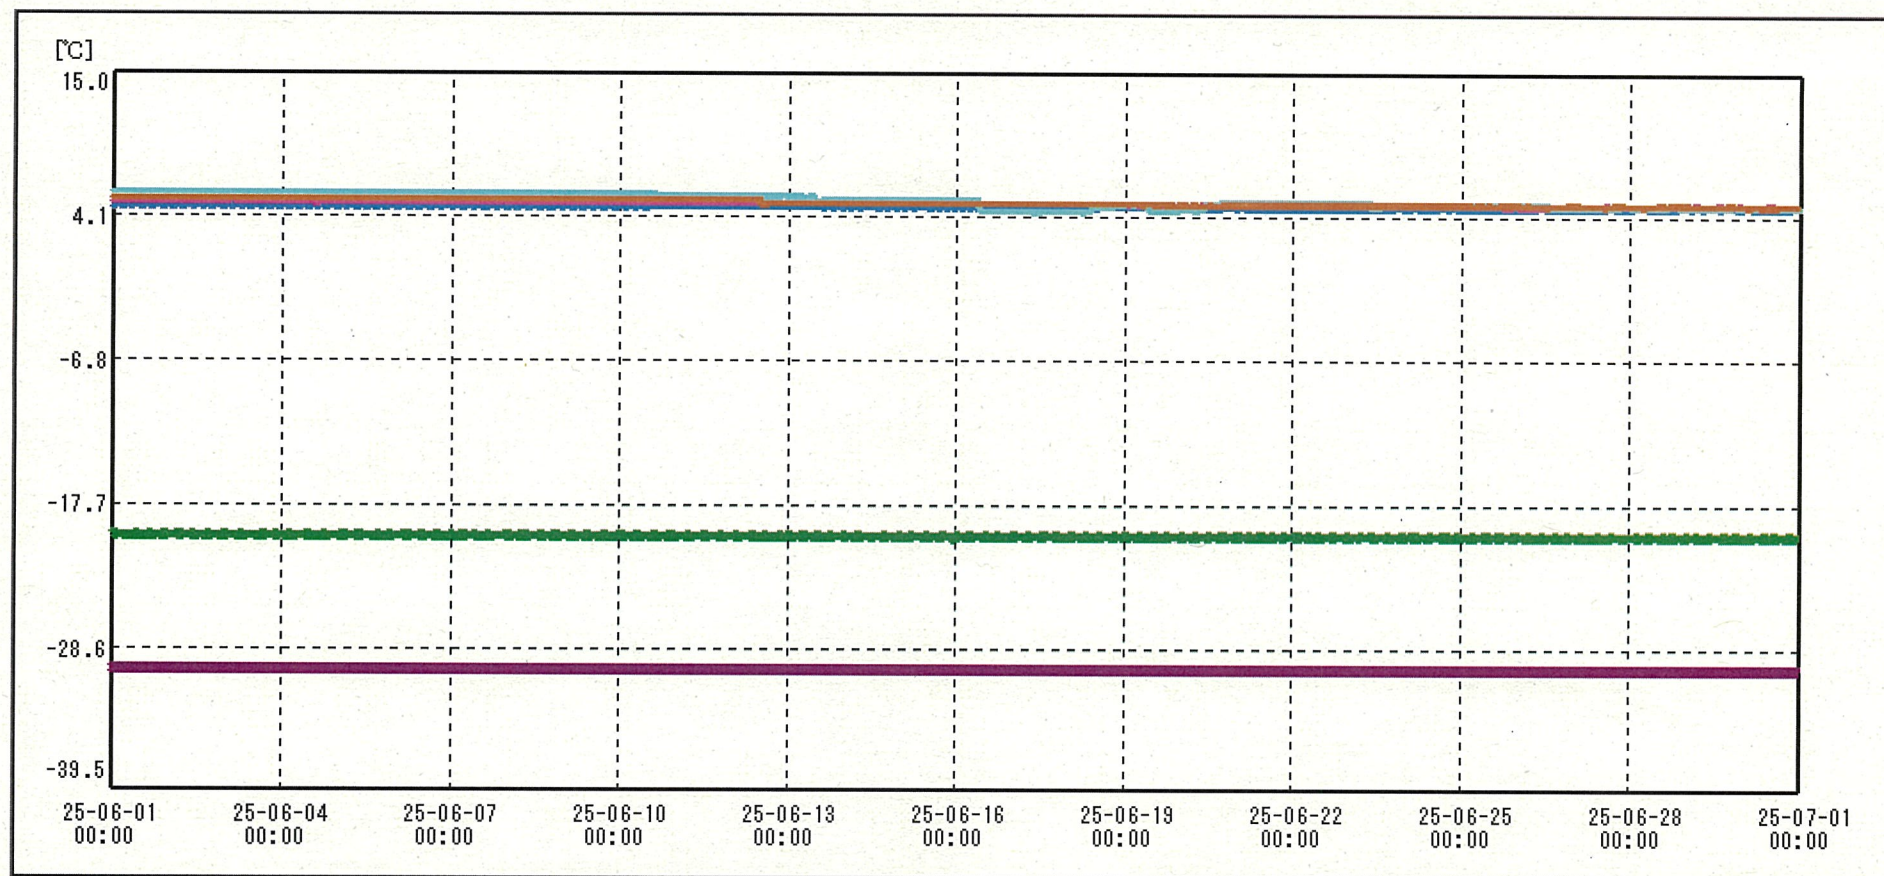

| 送信器名称<br>CH番号 | 治験冷凍庫Iの<br>CHI                      | 治験冷凍庫Cの<br>CHI                      | 治験冷凍庫Cの<br>CHI                      | 治験冷凍庫Hの<br>CHI                      | 治験保冷库Jの<br>CHI                      | 治験保冷库Kの<br>CHI                      |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位            | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   |
| 収録データ数        | 4320                                | 4320                                | 1440                                | 4320                                | 4320                                | 4320                                |
| 欠損データ数        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 測定間隔          | 00:10:00                            | 00:10:00                            | 00:30:00                            | 00:10:00                            | 00:10:00                            | 00:10:00                            |
| 最高値           | -29.9                               | 4.9                                 | -19.8                               | 5.4                                 | 5.9                                 | 5.5                                 |
| 最低値           | -30.4                               | 4.7                                 | -20.3                               | 4.9                                 | 4.4                                 | 4.9                                 |
| 平均値           | -30.1                               | 4.8                                 | -20.0                               | 5.1                                 | 5.4                                 | 5.2                                 |
| 開始日時          | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 |
| 終了日時          | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:30:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 |



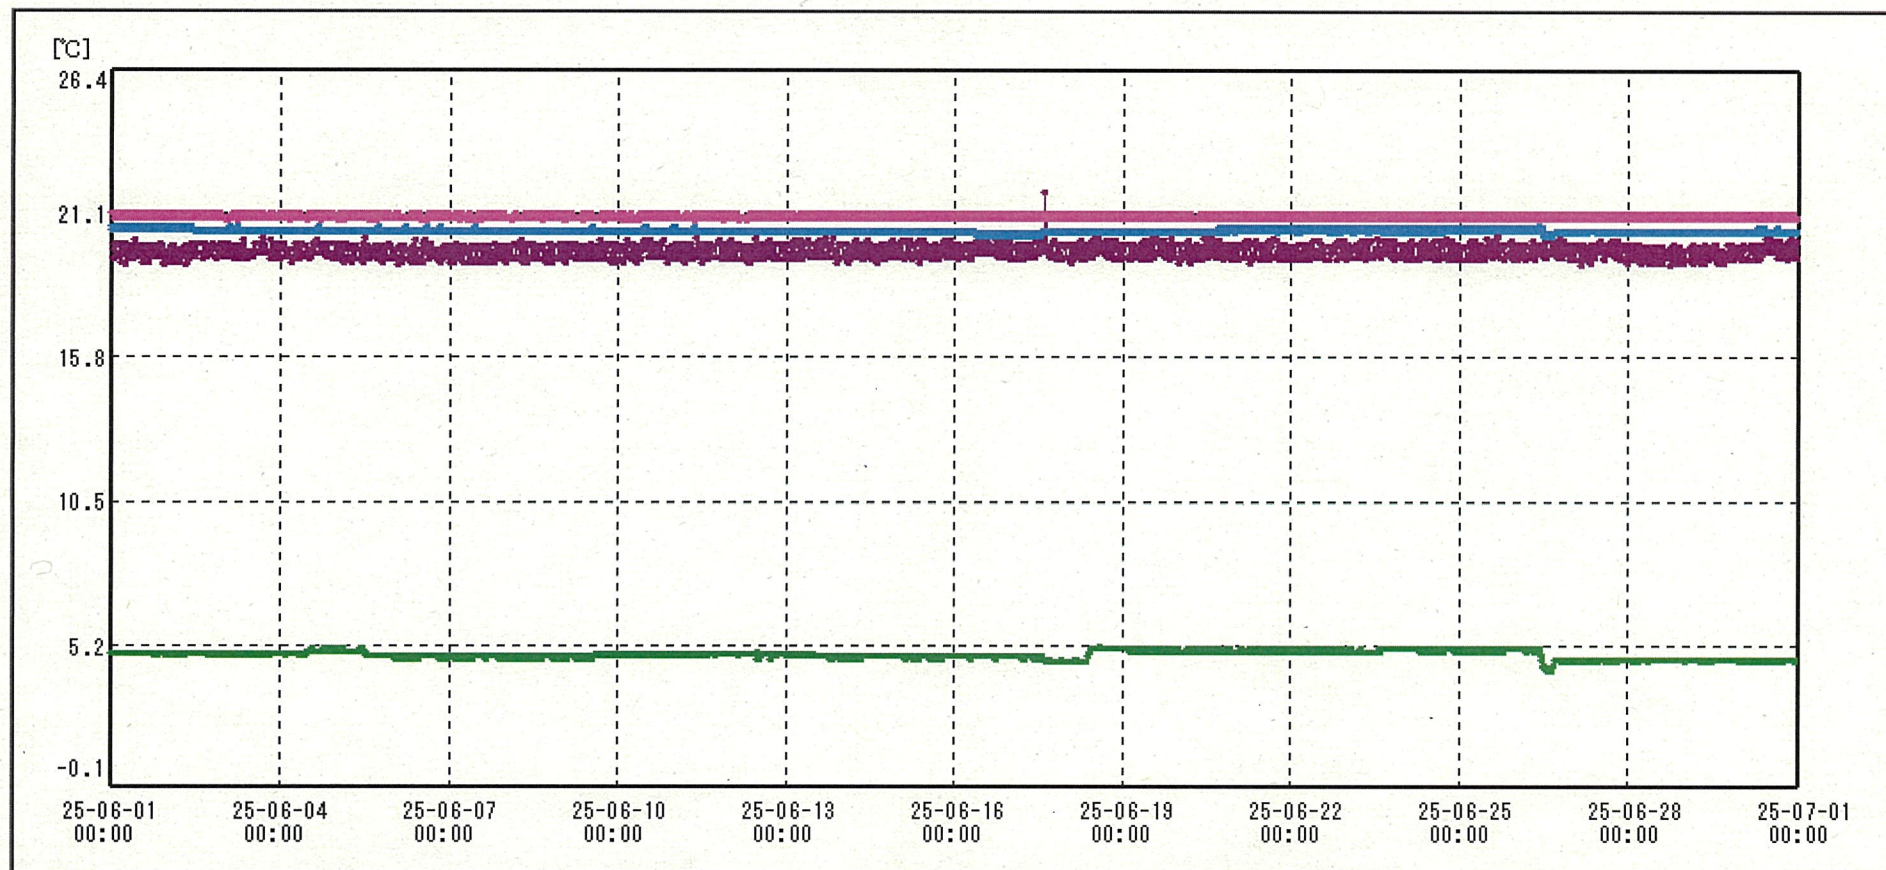

| 送信器名称<br>CH番号 | 治験保管庫室温②<br>CHI                     | 治験恒温槽B②<br>CHI                      | 治験冷蔵庫P②<br>CHI                      | 治験恒温槽Q②<br>CHI                      |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位            | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   |
| 収録データ数        | 4320                                | 4320                                | 4320                                | 4320                                |
| 欠損データ数        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 測定間隔          | 00:10:00                            | 00:10:00                            | 00:10:00                            | 00:10:00                            |
| 最高値           | 21.9                                | 20.7                                | 5.2                                 | 21.1                                |
| 最低値           | 19.2                                | 20.3                                | 4.3                                 | 20.8                                |
| 平均値           | 19.7                                | 20.5                                | 4.9                                 | 21.0                                |
| 開始日時          | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 | 2025/06/01 00:00:00                 |
| 終了日時          | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 | 2025/06/30 23:50:00                 |