




2026/6/2

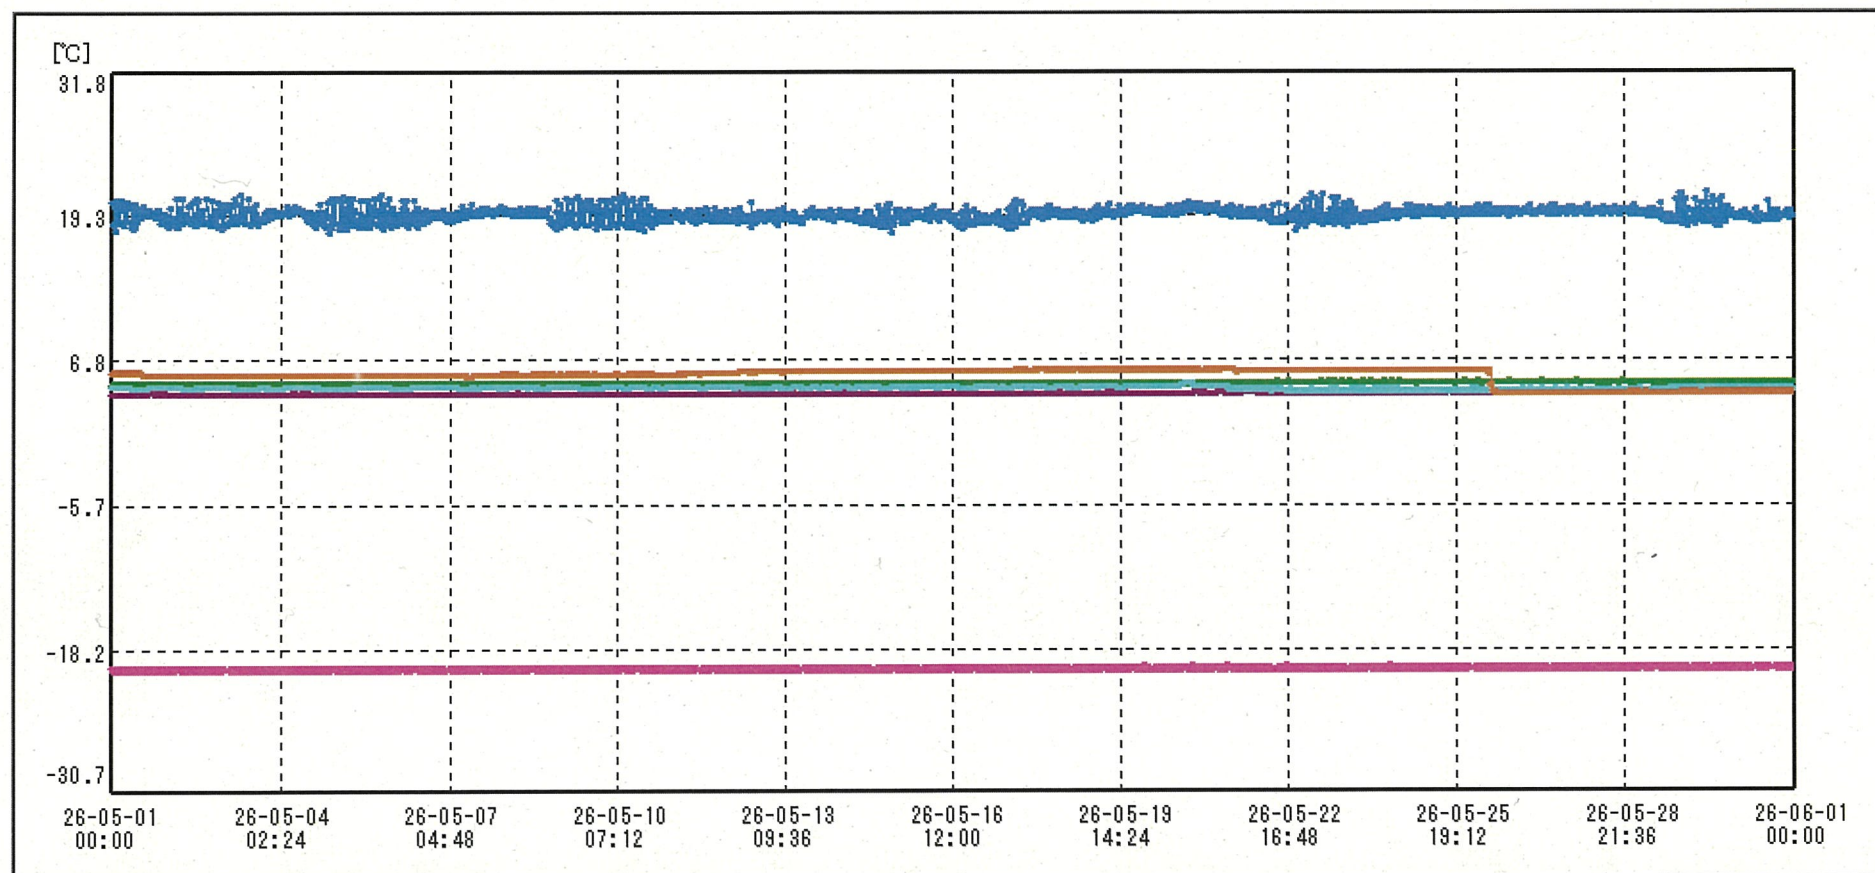

送信器名称 CH番号	治験冷蔵庫I① CHI	治験冷蔵庫I② CHI	治験冷蔵庫C① CHI	治験冷蔵庫C② CHI	治験冷蔵庫H① CHI	治験保冷庫J① CHI
▶ グラフ表示	☒	☒	☒	☒	☒	☒
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4464	4464	4464	1488	4464	4464
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:30:00	00:10:00	00:10:00
最高値	4.0	21.3	5.0	-19.6	4.9	6.1
最低値	3.8	17.8	4.6	-20.1	4.0	3.8
平均値	3.9	19.3	4.8	-19.9	4.4	5.4
開始日時	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00
終了日時	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:30:00	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:50:00

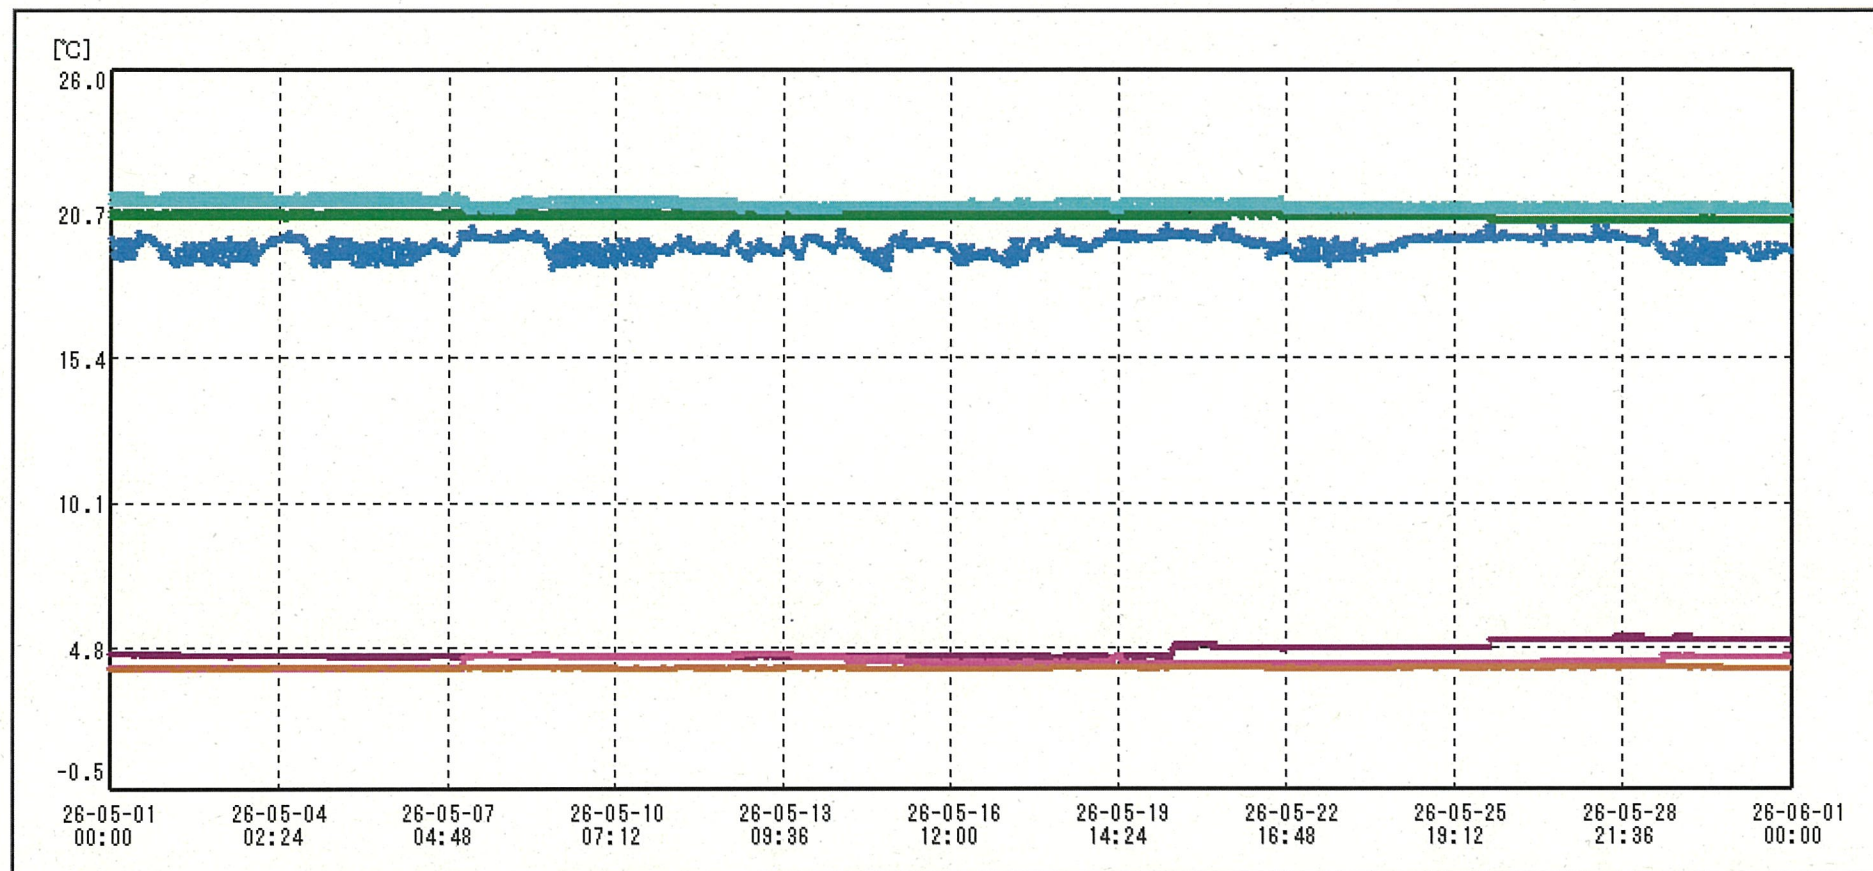

送信器名称 CH番号	治験冷蔵庫K① CHI	治験保管庫室温① CHI	治験恒温槽B① CHI	治験冷蔵庫P① CHI	治験恒温槽Q① CHI	治験冷蔵庫I① CHI
▶ グラフ表示	☒	☒	☒	☒	☒	☒
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4464	4464	4464	4464	4464	4464
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00
最高値	5.2	20.3	20.9	4.6	21.4	4.1
最低値	4.4	18.7	20.4	4.0	20.8	4.0
平均値	4.7	19.5	20.6	4.3	21.0	4.1
開始日時	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00
終了日時	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:50:00

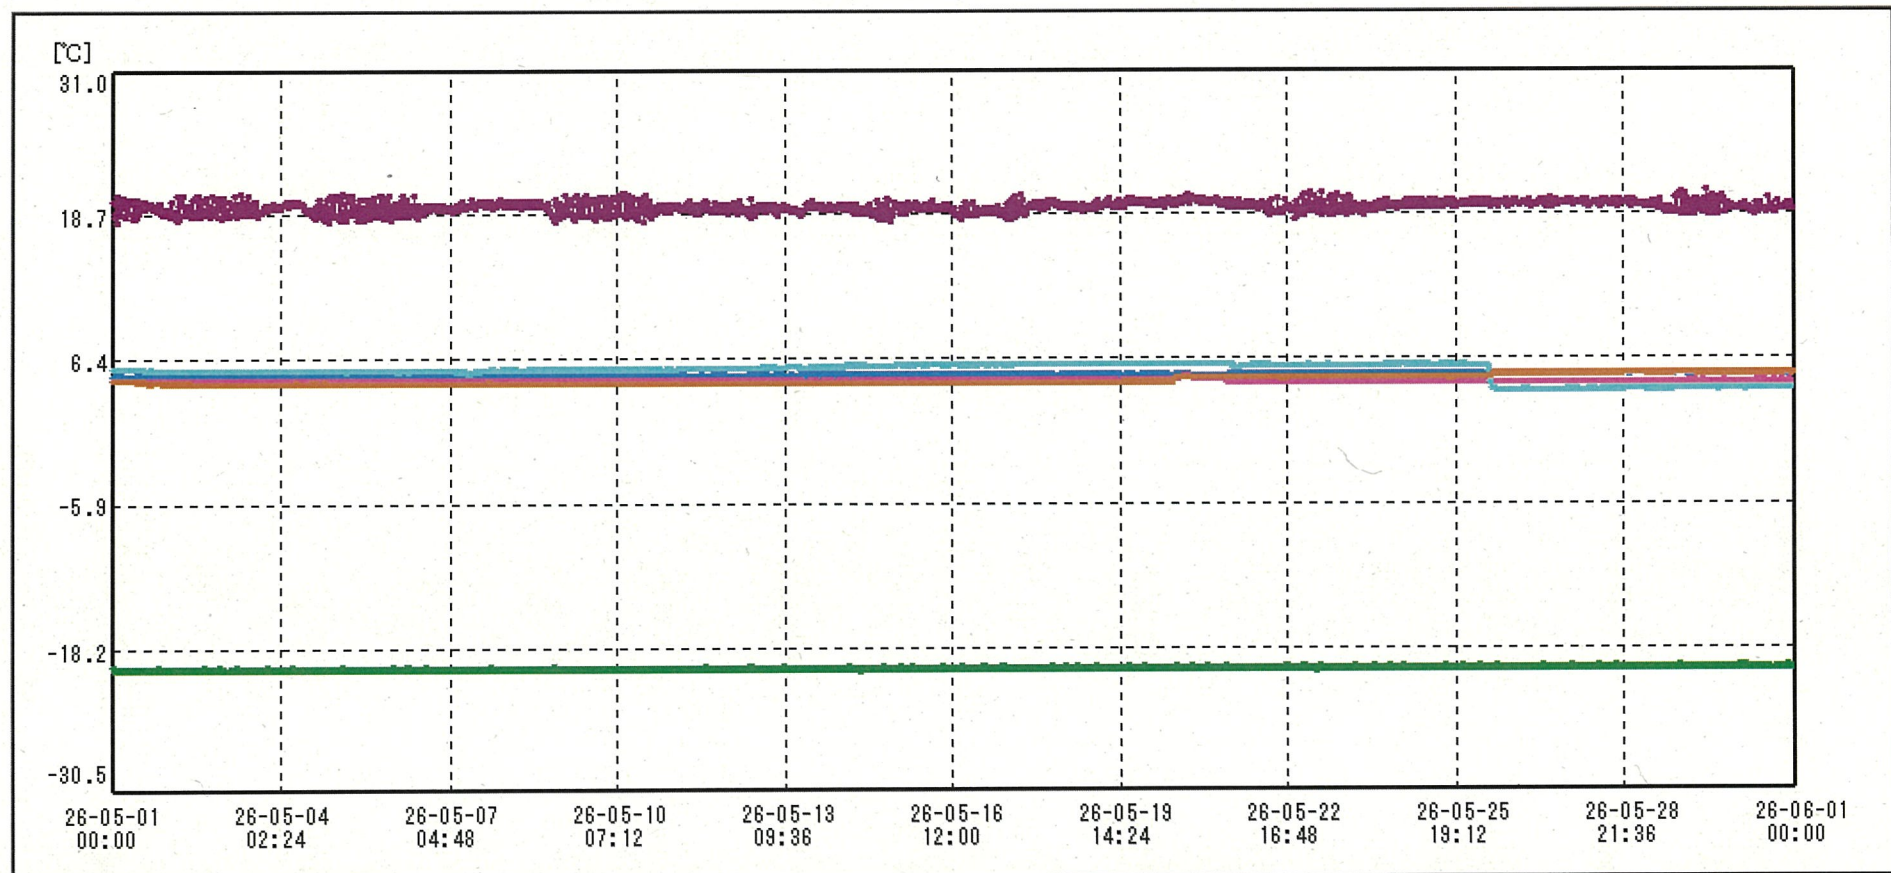

送信器名称 CH番号	治験冷蔵庫I② CHI	治験冷蔵庫C② CHI	治験冷蔵庫C② CHI	治験冷蔵庫H② CHI	治験保冷库J② CHI	治験冷蔵庫K② CHI
▶ グラフ表示	☒	☒	☒	☒	☒	☒
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4464	4464	1488	4464	4464	4464
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:30:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00
最高値	20.7	5.2	-19.7	5.0	6.0	5.1
最低値	18.0	4.9	-20.2	4.1	3.7	4.3
平均値	19.3	5.0	-20.0	4.5	5.3	4.6
開始日時	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00	2026/05/01 00:00:00
終了日時	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:30:00	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:50:00	2026/05/31 23:50:00

